



**CUIDADO**

# **RESPIRATORIO**

---

# Tabla de Contenido

## CUIDADO INTENSIVO

### SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA TRACH CARE®-----02-03

Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE® TET/TQM Turbo Cleaning Wet Pack® MDI. Avanos™

Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE® TQM MDI en «T». Avanos™

Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE® TET MDI. Avanos™

Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE® TET / TQM. Avanos™

Sistema cerrado para succión traqueal continua TRACH CARE® TET neonatal/pediátrico. Avanos™

TRACH CARE® Catéter multi-acceso MAC 5 Fr. Avanos™

---

Mini Bal® - Catéter para lavado broncoalveolar catéter externo. Avanos™----- 04

Trampa de Luken - Recolector para muestra de secreciones bronquiales----- 04

### MÁSCARAS PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA-----05-06

Máscara BiTrac® NIV Shield, arnés reutilizable. Pulmonary®

Máscara Bitrac® Maxshield™. Pulmonary®

Máscara BiTrac® Full Face, codo estándar. Pulmonary®

Máscara BiTrac® Nasal, codo estándar. Pulmonary®

### REHABILITACIÓN PULMONAR-----07

AccuPAP. Dispositivo para terapia PEP con regulador para PEEP. Pulmonary®

### ANESTESIA-----07

Cánula nasal dividida para medición de CO<sub>2</sub> y suministro de O<sub>2</sub> simultáneo. Salter Labs®

### CPAP SIN VENTILADOR -----07

O2-Max® TRIO máscara BiTrac. CPAP. Pulmonary®



**minerva**  
medical

- Bogotá: Cra. 72 No. 127C - 91 / Teléfono: (+57) 6012268111
- Medellín: Cra. 50FF No.8 SUR - 27 Oficina 312 del EDIFICIO OCHO CERO OCHO.  
Teléfono: (+57) 6043666284 - (+57) 6043666317
- Cali: Av. 6N No.17 - 92 Oficina: 314 / Teléfono: (+57) 6024850200
- Bucaramanga: Cra. 28 16 21 San Alonso. Teléfono (+57) 3163327343
- Pereira: Calle 15 No. 4a - 236 Zapan torre 3 Apto. 1202.  
Dosquebradas Risaralda. Celular: (+57) 3155819295
- Cartagena: Pie de la popa, Calle Mompox No. 30-102 Local B3.  
Teléfono: 6056560025 (Ext. 26)
- Pasto: Condominio Morasurco, Cra. 45 No. 20 B 31 bloque 2 Apto. 203.  
Celular: (+57) 3175031028
- Ibaguè: Cra 6 #47-42 oficina 403 edificio Catumare barrio Piedra Pintada

[www.minervamedical.com.co](http://www.minervamedical.com.co)

## TRACH CARE® TET/TQM Turbo Cleaning Wet Pack® MDI. Avanos™

Reduce hasta en un 89% la colonización por patógenos de la punta de la sonda. Con una cámara única, aislada y cerrada al vacío que permite la limpieza de la sonda. Sellada en los extremos por la tecnología de sellos de PEEP patentada por el fabricante. Permite el uso de la sonda hasta por 72 horas.

[Ver ficha técnica](#)

## TRACH CARE® TQM MDI en «T». Avanos™

-EVITA pérdida de parámetros ventilatorios manteniendo al paciente en niveles terapéuticos de oxigenación durante el procedimiento.

-LIMPIEZA SEGURA de secreciones pulmonares sin afectar la oxigenación y las presiones de reclutamiento de la vía aérea.

[Ver ficha técnica](#)

## TRACH CARE® TED MDI Avanos™

-DISMINUYE significativamente el riesgo de sobreinfecciones secundarias a la colonización bacteriana y/o viral.

-EVITA el efecto de torque sobre la vía aérea artificial causado por los movimientos del paciente y EVITA posibles interrupciones de la ventilación por desconexión.

[Ver ficha técnica](#)



Ref. 22712186-5



Ref. 2201358



Ref. 22108-5

**minerva**  
medical

## TRACH CARE® TET / TQM. Avanos™

- Impide alteraciones de la ventilación y el trabajo respiratorio del paciente, precisando SEGURIDAD Y EXACTITUD.
- MINIMIZA los riesgos de mayor colonización y su consecuente sobreinfección durante la ventilación mecánica.

[Ver ficha técnica](#)

## TRACH CARE® TET neonatal/pediátrico. Avanos™

- Oxigenación y apertura alveolar sin interrupción.
- Menor riesgo de infecciones asociadas a la ventilación mecánica.
- Protección de la oxigenación, eficacia en la higiene y menor riesgo de sobreinfección para el paciente.

[Ver ficha técnica](#)

## TRACH CARE® Catéter multi-acceso MAC. Avanos™

- Menor trabajo respiratorio, baja resistencia pulmonar y ventilación ÓPTIMA evitando lesiones de la mucosa y atelectasias asociadas a succión profunda.
- Ventilación ESTABLE y SEGURA sin lesiones de la mucosa o desreclutamiento por inserción profunda.

[Ver ficha técnica](#)



Ref. 221036-5



Ref. 196-5



Ref. 1900

**minerva**  
medical

## Mini Bal<sup>®</sup>. Avanos<sup>™</sup>


El catéter Mini-Bal<sup>®</sup> permite hacer un lavado broncoalveolar (BAL) seguro, sin pérdida de rendimiento diagnóstico, cuando la visualización no sea necesaria en pacientes mecánicamente ventilados.

[Ver ficha técnica](#)

## Trampa de Luken

Trampa de Luken o recolectora de secreciones. Conexiones seguras y herméticas para recolectar muestras de secreciones para laboratorio.

[Ver ficha técnica](#)

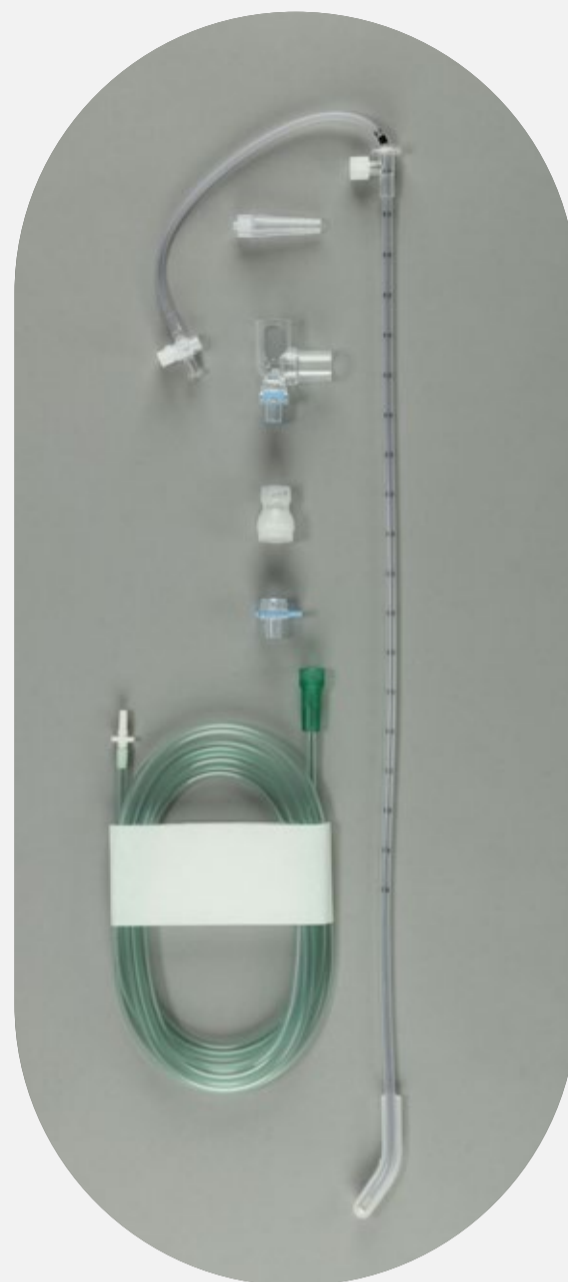

Ref. 142



Ref. 8884724500

**minerva**  
medical

## Máscara BiTrac® NIV Shield™ Pulmodyne®

Ofrece un sello completo del perímetro facial, gracias al cojín de silicona que viene disponible en un solo tamaño. Lo que la convierte en una herramienta rápida y fácil de usar al no requerir pasar por el proceso de ajuste de la máscara.

[Ver ficha técnica](#)

## Máscara Bitrac® Maxshield™ Pulmodyne®

Nuestra máscara BiTrac® MaxShield™ se apoya en el contorno de la cara y cubre totalmente la superficie facial; ofrece un cojín de silicona para un perímetro facial completo y viene disponible en dos tamaños.

[Ver ficha técnica](#)

CODO ANTIASFIXIA  
Ref. 313-9050



CODO ESTÁNDAR  
Ref. 313-9051

CODO ANTIASFIXIA  
Ref. 313-9054



CODO ESTÁNDAR  
Ref. 313-9551

**minerva**  
medical

## Máscara Bitrac® Maxshield™. Pulmodyne®

Se acomoda a la población infantil. Ofrece un ajuste completo al contorno del paciente y permite una visión clara, ayudando a reducir la claustrofobia. Brinda también un proceso de ajuste más rápido y sencillo. Dispone de un cojín de silicona para un perímetro facial completo y viene disponible en dos tamaños.

[Ver ficha técnica](#)

## Máscara Bitrac® Full Face. Pulmodyne®

Está diseñada para la ventilación no invasiva. Estas mascarillas cubren la nariz y la boca, pueden adaptarse de manera fácil a la cara del paciente, proporcionando máximo confort y un sellado eficaz.


[Ver ficha técnica](#)

## Máscara Bitrac® Nasal. Pulmodyne®


Hace posible la adaptación entre el paciente y el ventilador mecánico. La máscara se adapta con precisión a la nariz proporcionando el máximo confort y un sellado eficaz.

[Ver ficha técnica](#)

PEDIÁTRICA  
CODO ANTIASFIXIA  
Ref. 313-9527

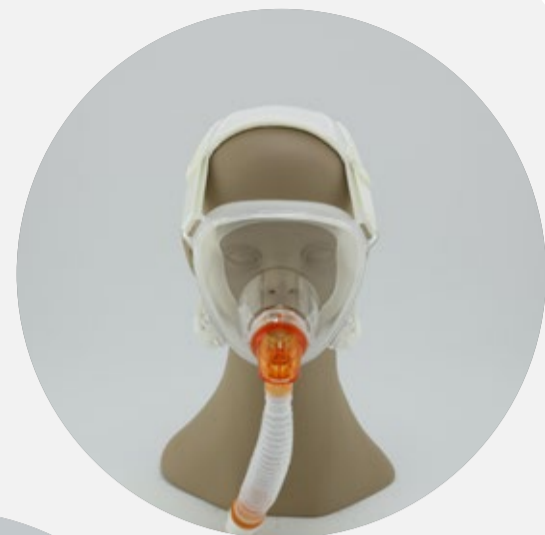

PEDIÁTRICA  
CODO ESTÁNDAR  
Ref. 313-9525

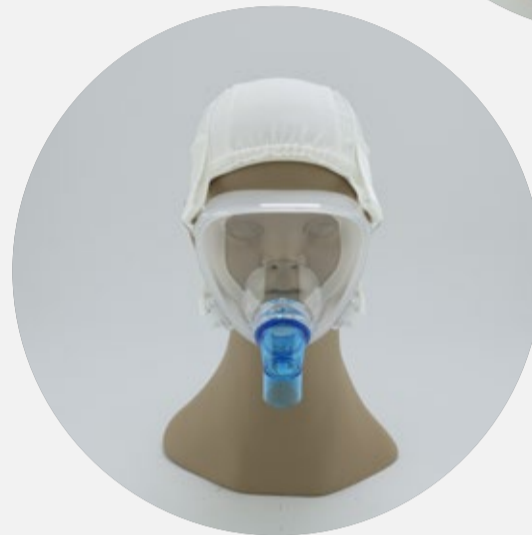

CODO ESTÁNDAR  
Ref. 313-9509



CODO ESTÁNDAR  
Ref. 313-9014



**minerva**  
medical



## AccuPAP™ Pulmodyne®

Permite la ejecución de forma autónoma por el paciente y consiste en un sistema mecánico, tipo resorte, que basa su funcionamiento en el siguiente principio: producir una resistencia al flujo aéreo espiratorio, generando así una presión positiva al interior de la vía aérea, que favorece la apertura alveolar y el intercambio gaseoso.

[Ver ficha técnica](#)

## Cánula nasal dividida. Salter Labs®

Está disponible en diferentes tamaños, desde recién nacido hasta adulto y presenta una gran variedad de conexiones para permitir su utilización con cualquier monitor actual de CO<sub>2</sub>.

[Ver ficha técnica](#)

## O2-Max® TRIO máscara BiTrac. CPAP. Pulmodyne®

Es un dispositivo para suministrar presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) a pacientes adultos de más de 30 kg, que respiran espontáneamente en entornos hospitalarios y prehospitalarios.

[Ver ficha técnica](#)

### REHABILITACIÓN PULMONAR



Ref. 313-600

### ANESTESIA



Ref. 4707F-7-7

### CPAP SIN VENTILADOR



Ref. 313-8108X 02

**minerva**  
medical



**minerva**  
medical

- Bogotá: Cra. 72 No. 127C - 91 / Teléfono: (+57) 6012268111
- Medellín: Cra. 50FF No.8 SUR - 27 Oficina 312 del EDIFICIO OCHO CERO OCHO.  
Teléfono: (+57) 6043666284 - (+57) 6043666317
- Cali: Av. 6N No.17 - 92 Oficina: 314 / Teléfono: (+57) 6024850200
- Bucaramanga: Cra. 28 16 21 San Alonso. Teléfono (+57) 3163327343
- Pereira: Calle 15 No. 4a - 236 Zapan torre 3 Apto. 1202.  
Dosquebradas Risaralda. Celular: (+57) 3155819295
- Cartagena: Pie de la popa, Calle Mompox No. 30-102 Local B3.  
Teléfono: 6056560025 (Ext. 26)
- Pasto: Condominio Morasurco, Cra. 45 No. 20 B 31 bloque 2 Apto. 203.  
Celular: (+57) 3175031028
- Ibagué: Cra 6 #47-42 oficina 403 edificio Catumare barrio Piedra Pintada

[www.minervamedical.com.co](http://www.minervamedical.com.co)